

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ



Аксессуары и расходные материалы

Уход за наконечниками и микромоторами

REF 2127

Спрей NouvaClean для чистки микромотора и наконечников 500 мл



REF 2128

Спрей NouvaOil для смазки микромотора и наконечников 500 мл

REF 1958

Адаптер для смазки редуктора E-фитинг



REF 1974

Спрей адаптер для смазки/ухода для элетро-микромотора 21

REF 1029

Чемодан для моторных систем и их аксессуаров



REF 4118

Транспортный кейс с пенопластовой вставкой для транспортировки и хранения HighSurg 11 и его аксессуаров.

REF 9985M

Для стерилизации боров (сверл) подставка до 14 предметов.



REF 4113

Лоток для стерилизации (465 x 280 x 100 mm)

Стойки для аппаратов

REF 4122

Стойка передвижная. Оснащена нижней и верхней полкой. 4 антистатических валка, 2 из которых закрываются



REF 1898


Стойка передвижная, без стойки для емкостей
Масса: 20 кг



Уход за наконечниками и микромоторами


Продлите жизнь своим инструментам

1. Предварительная подготовка для очистки и дезинфекции.

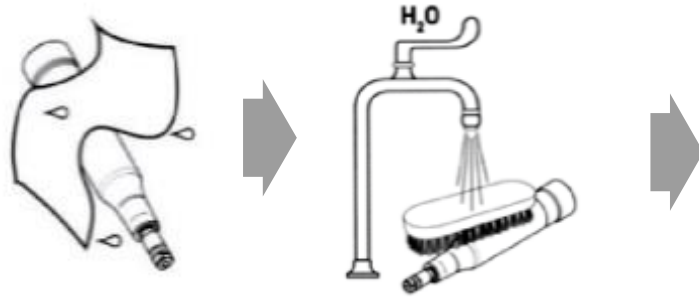

Нужно удалить мелкие детали (охлаждающий наконечник, зажим для шлангов, накидные гайки и т.д.), инструменты и аксессуары протереть влажной салфеткой.

Очистите инструменты и принадлежности под проточной водой с помощью мягкой щетки.

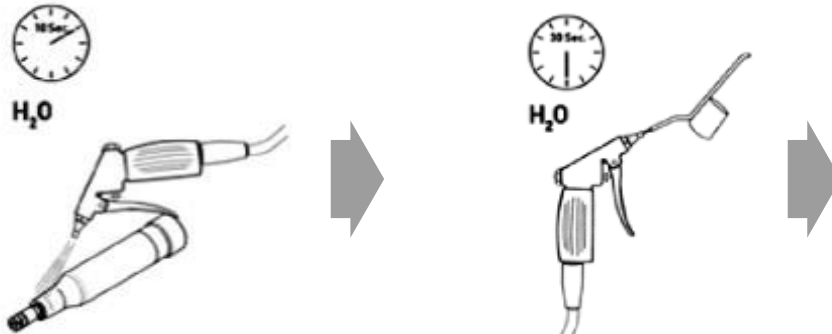

Промойте инструмент водяным пистолетом (10 сек).

Промойте части с отверстиями с помощью водяного пистолета и насадки для шприца в течении 30 секунд.

Промойте наконечники/угловые наконечники спреем NOUVA - Clean до тех пор, пока не будет выходить чистая жидкость.

ВНИМАНИЕ!

Спрей Nouva-Clean для микромоторов использовать запрещено! Только для наконечников!

Для микромоторов использовать только Nouva-Oil.

Nouva-Oil обеспечивает идеальную смазку для всех движущихся частей внутри инструмента.

2. Ручная очистка, дезинфекция, сушка.



Разберите мелкие детали, наконечники/ угловые наконечники и очистите в ультразвуковой ванне с ферментативным очистителем 2% ID215, 15 минут.

Очистите мягкой щеткой и ополосните под проточной водой.




Промойте отверстия с помощью водяного пистолета и насадки-шприца в течение 30 сек.

Поместите изделие в ультразвуковую ванну с дезинфицирующим раствором 2% ID212 на 5 мин.

Удалите остатки воды бумажным полотенцем и продуйте сжатым воздухом.

3. Механическая очистка, дезинфекция, сушка.




Вставьте наконечники/угловые наконечники или микромоторы и т.д. в корзину.

ID 215



Neodisher Mediclean Программа Vario TD в установке очистки и дезинфекции (RGD) с деионизированной водой, включая сушку (40C0, 0,5% ID 215) или (55C0, 0,5% Neodisher Mediclean).

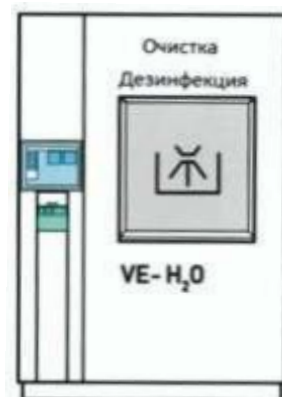

4. Контроль и уход.



Отсоедините кабель от микромотора прикрутите адаптер распылителя к микромотору и подсоедините синюю форсунку. Всплеск распыления примерно 3 секунды.



Осмотрите микромотор/наконечник на наличие повреждений или износа.

5. Стерилизация.



Процесс паровой стерилизации с фракционированным предварительным вакуумом в 3 этапа:
Температура от 132°C до 135°C
Время выдержки не менее 3 минут.
Время высыхания 20-30 минут.

6. Хранение.



Защита от пыли, влаги и загрязнения.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Стерильная упаковка перед использованием (проверить очередь).
Обратите внимание на срок годности.
Соблюдайте правила асептики.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ (для всех направлений)

Микромоторы

2090n	Микромотор 21 для TCM 300BL морцеллятор
2098n	Микромотор 21 80 000' для HighSurg 30
2099n	Микромотор 21 50 000' HighSurg30/11
2112n	Микромотор 21 50 000' для TCM 300BL
2101n	Микромотор 21 для Vacuson 60LP Conform-cannula

Адаптеры для спрея

1984	Спрей NouClean для смазки/ чистки микромотора и наконечников
1974	Адаптер для спрея для Микромотора 21
1958	Адаптер для спрея для редуктор Морцеллятора/ наконечники HighSurg
1942	Адаптер для спрея для Микромотора 31 ESS

Педали управления для аппаратов

1513	ON/OFF-Pedal IP 68, для операционных процедур для Dispenser DP 20 & DP30
1501	Vario-Pedal IP 68, для операционных процедур для Dispenser DP 20 & DP30
1507	Vario-педаль IP 68 для TCM 300BL морцеллятор
1510	Vario-Pedal для HighSurg 30
1866	Vario-Pedal для HighSurg 11/Ofa drill
4242	Педаль для регулирования Вакуума для Vacuson 40 - 60 в комплекте с силиконовой трубкой 2 м (4076) и коннектором (4056)
15012	Педаль ON/OFF пневматическая педаль новая версия, для управления Vacuson 40/60
1861	Vario-Pedal IP 68, для Vacuson 60LP

Трубки

6022	Комплект трубок, одноразовые, стерильные, 4 м, для инфльтрации
6024	Стандартная одноразовая трубка устанавливается для HighSurg11, HighSurg30 для охлаждения любого наконечника. Стерильная 2 м (упаковка 10 шт)
6025	Трубка со встроенным 3-х ходовым вентелем для HighSurg 30 для охлаждения. Стерильная, одноразовая набор трубки. (упаковка 10шт)
6026	Комплект трубок, одноразовые, стерильные, Ø 5 x 9 мм, 4 м, для всасывания (упак 10шт) для Vacuson 40/60/60LP
28535	Коннектор для соединения крышки 4058 с трубкой 28966 / 6026
4076	Трубка для насоса (силикон, запасная) 2 м, Ø 8x14 мм для Vacuson 40/60
26014	Трубка для насоса силиконовая Ø 6 mm, 2m для Vacuson 18
4190	Соединительная трубка "бактериальный фильтр - емкость" для Vacuson 18 / 40 / 60 / 60LP
4118	Держатель для всасывающих трубок

Фильтры

4246	Бактериальный фильтр для Vacuson 18 / 40 / 60 / 60LP
------	--

Стерилизационные и транспортные кейсы

4113	Стерилизационный алюминиевый кейс 465x280x110 без перфорации
4128	Стерилизационный алюминиевый кейс 465x280x150 без перфорации
4126	Силиконовый нескользящий мат 440x230мм
4127	Одноразовые фильтр-пакеты для стерилизации (упак 100шт)
4131	Стерилизационный алюминиевый кейс с фиксаторами для Дерматома
4132	Стерилизационный алюминиевый кейс с фиксаторами для Нейрохирургических наконечников
4133	Крышка для стерилизационного кейса 4131
4134	Крышка для стерилизационного кейса 4132
5202	Транспортный кейс
4118	Транспортный кейс для HighSurg11
9985M	Стерилизационный алюминиевый кейс с фиксаторами для боров (сверл) до 14 предметов

Фиксаторы для труб

1881	Зажимы для крепления трубки охлаждения на наконечник (3шт) стерилизуемые
1873	Клипсы для крепления трубки охлаждения на кабеле питания. (10шт) стерилизуемые
1170	Подставка для наконечника

Емкости для отсасывателей

4033	Бутыль для отсасываемой жидкости 1,5 л Изготовлена из полисульфона в комплекте с крышкой, для VACUSON 18
4049	Бутыль для отсасываемой жидкости 1,5 л Изготовлена из полисульфона для VACUSON 18
4039	Крышка с контролем переполнения для емкости 1,5 л для VACUSON 18
4052	Бутыль для отсасываемой жидкости 2 л изготовлена из полисульфона, для Vacuson 40/60 и 60LP
4245	Бутыль для отсасываемой жидкости 5 л изготовлена из полисульфона, только для Vacuson 40/60 и 60LP крепить только на мобильный стенд!
4058	Крышка с контролем переполнения для емкостей 2 и 5 л для Vacuson 40/60 и 60LP
4030	Емкость 2л с крышкой и держателем с 1 одноразовым мешком Monokit (стартовый набор)
4035	Крышка с мягкой емкостью, одноразовая (комплект из 50 единиц)
4036	Емкость 2л, автоклавируемая для Monokit
4037	Держатель к блоку для емкости Monokit
4043	Колчан 30 см, автоклавируемый (Для дез. раствора для канюль)
4044	Колчан 40 см, автоклавируемый (Для дез. раствора для канюль)

Хирургические канюли

4446	Аспирационная канюля с отверстием в центре, 28 cm Yankauer Ø 2,0 мм. Для общей хирургии
4449	Аспирационная канюля с отверстием в центре, 24 cm Andrews-Punchon Ø 2,0 мм. Для общей хирургии
4516	Аспирационная канюля с наружным патрубком Ø 6 mm Poole Для абдоминальной хирургии, также может применяться в качестве инфузионного катетера
4420	Соединительный коннектор, стерилизуемый для аспирационных кюреток 4425-4430
4425	Аспирационная кюретка, Ø 4 mm для гинекологии
4426	Аспирационная кюретка, Ø 6 mm для гинекологии
4427	Аспирационная кюретка, Ø 8 mm для гинекологии
4428	Аспирационная кюретка, Ø 10 mm для гинекологии
4429	Аспирационная кюретка, Ø 12 mm для гинекологии
4430	Аспирационная кюретка, Ø 14 mm для гинекологии

Стойки для аппаратов

4122	Стойка мобильная однополочная для Vacuson 40 - 60
1898	Стойка мобильная двухполочная без держателя бутылки



www.medtehural.ru